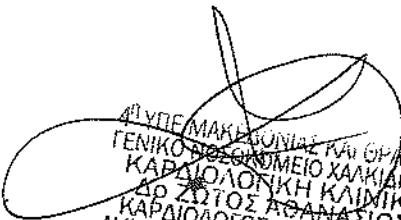


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ HOLTER ΡΥΘΜΟΥ

1. Το καταγραφικό να διαθέτει κατά την καταγραφή δειγματοληψία 180 δείγματα ανά δευτερόλεπτο, 12 bit A/D Conversion, να λειτουργεί με εσωτερική μνήμη και μια μπαταρία μεγέθους AAA.
2. Το καταγραφικό να έχει βάρος μικρότερο από 30g.
3. Το καταγραφικό να είναι 3 απαγωγών.
4. Το καταγραφικό να έχει οθόνη για την απεικόνιση των επαρμάτων και επίσης να έχουν την δυνατότητα ελέγχου των ηλεκτροδίων.
5. Το καταγραφικό να έχει την δυνατότητα αναγνώρισης βηματοδότη.
6. Το καταγραφικό να είναι συμβατό με το υπάρχον σύστημα του νοσοκομείου H-SCRIBE .


Δ^ΗΥΠΕ ΜΑΚΙΝΙΟΥΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Δ^Ρ ΖΩΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΜΚΑ 27076904716 ΑΜ ΤΣΑΥ 92696